


Анализатор-аммония

(Согласно DIN EN ISO 11732)

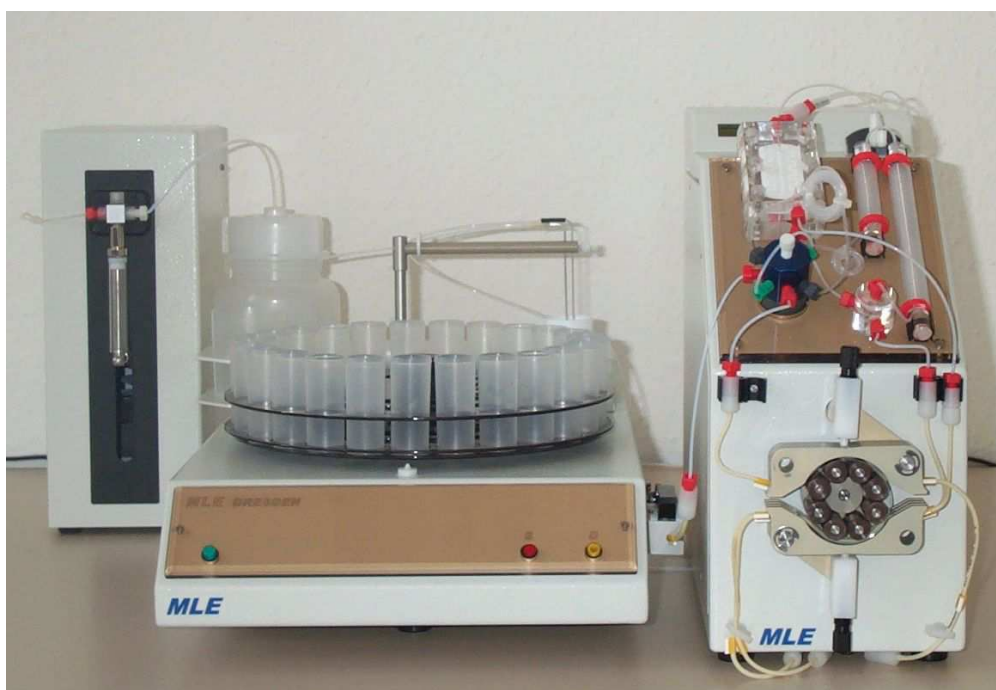

Аммоний, который присутствует в пробах, переводится в аммиак при помощи щелочного раствора. Аммиак диффундирует через газопроницаемую мембрану, в процессе изменяется значение рН и цвет индикатора. Для увеличения чувствительности можно использовать широкодиапазонную ячейку для газовой диффузии.

Диапазоны измерения: Аммоний	0,1 ... 1 мг/л NH ₄ -N
	0,5 ... 10 мг/л NH ₄ -N
	2 ... 50 мг/л NH ₄ -N
Аммоний-WB	0,02 ... 1 мг/л NH ₄ -N
	0,2 ... 5 мг/л NH ₄ -N
	2 ... 20 мг/л NH ₄ -N